

รศ. - G050/2570

สสช. - G050/2569

สสช. - G050/2568


สสช.-G050/2657

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Electroporation cuvettes ช่องขนาด 0.2 เซนติเมตร

1. เป็นคิวเวตสำหรับใส่สารตัวอย่างใช้ในการส่งถ่ายสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ โดยใช้กับตัวอย่าง bacteria, yeast และ mammalian cells ได้
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 มีระยะห่างภายในช่องคิวเวต 0.2 เซนติเมตร รองรับตัวอย่างปริมาณสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 ไมโครลิตร
 - 2.2 สามารถใช้ร่วมกับเครื่อง Electroporator ยี่ห้อ Bio-Rad ได้
 - 2.3 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ (sterile)
 - 2.4 ผลิตจาก Polycarbonate
 - 2.5 มีฝาปิดคิวเวตสีเขียวย (Color codes) เพื่อความสะดวกในการใช้แยกขนาดของคิวเวตให้ถูกต้องกับตัวอย่างใช้งาน
3. บรรจุแบบแยกชิ้น และจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชิ้นต่อแพ็ค
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันที่ยื่นส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบโดยระบุวันหมดอายุ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

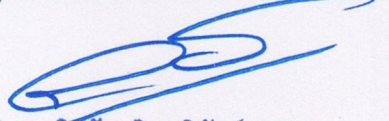

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)

.....กรรมการ
(นายเชษฐา รัตโนภาส)

.....กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางจันทร์ วัฒนเมธานนท์)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ